


Startfrequenz: 0.000000 MHz; Endfrequenz: 159.997994 MHz; Schrittweite: 32.006 kHz  
Messpunkte: 5000; Zwischenzeit: 1000 uSek

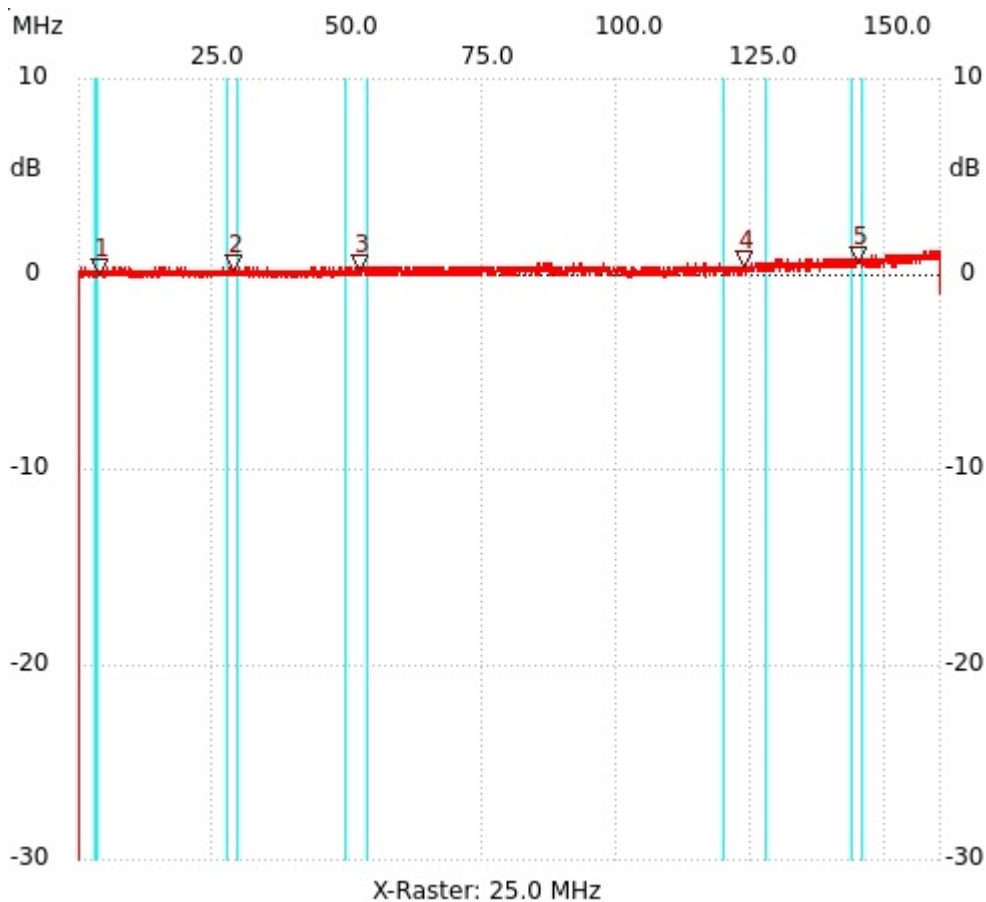

;de0508 Circulator/ Isolator S21, P3 Kanal 1 abgelesen.

-----  
Kursor 1: Kanal 1  
3.584672 MHz max:1.14dB 156.893412MHz  
Kanal1: 0.00dB min:-64.79dB 0.000000MHz  
-----

Kursor 2:  
28.709382 MHz  
Kanal1: 0.19dB  
-----

Kursor 3:  
51.945738 MHz  
Kanal1: 0.19dB  
-----

Kursor 4:  
123.671184 MHz  
Kanal1: 0.38dB  
-----

Kursor 5:  
144.923168 MHz