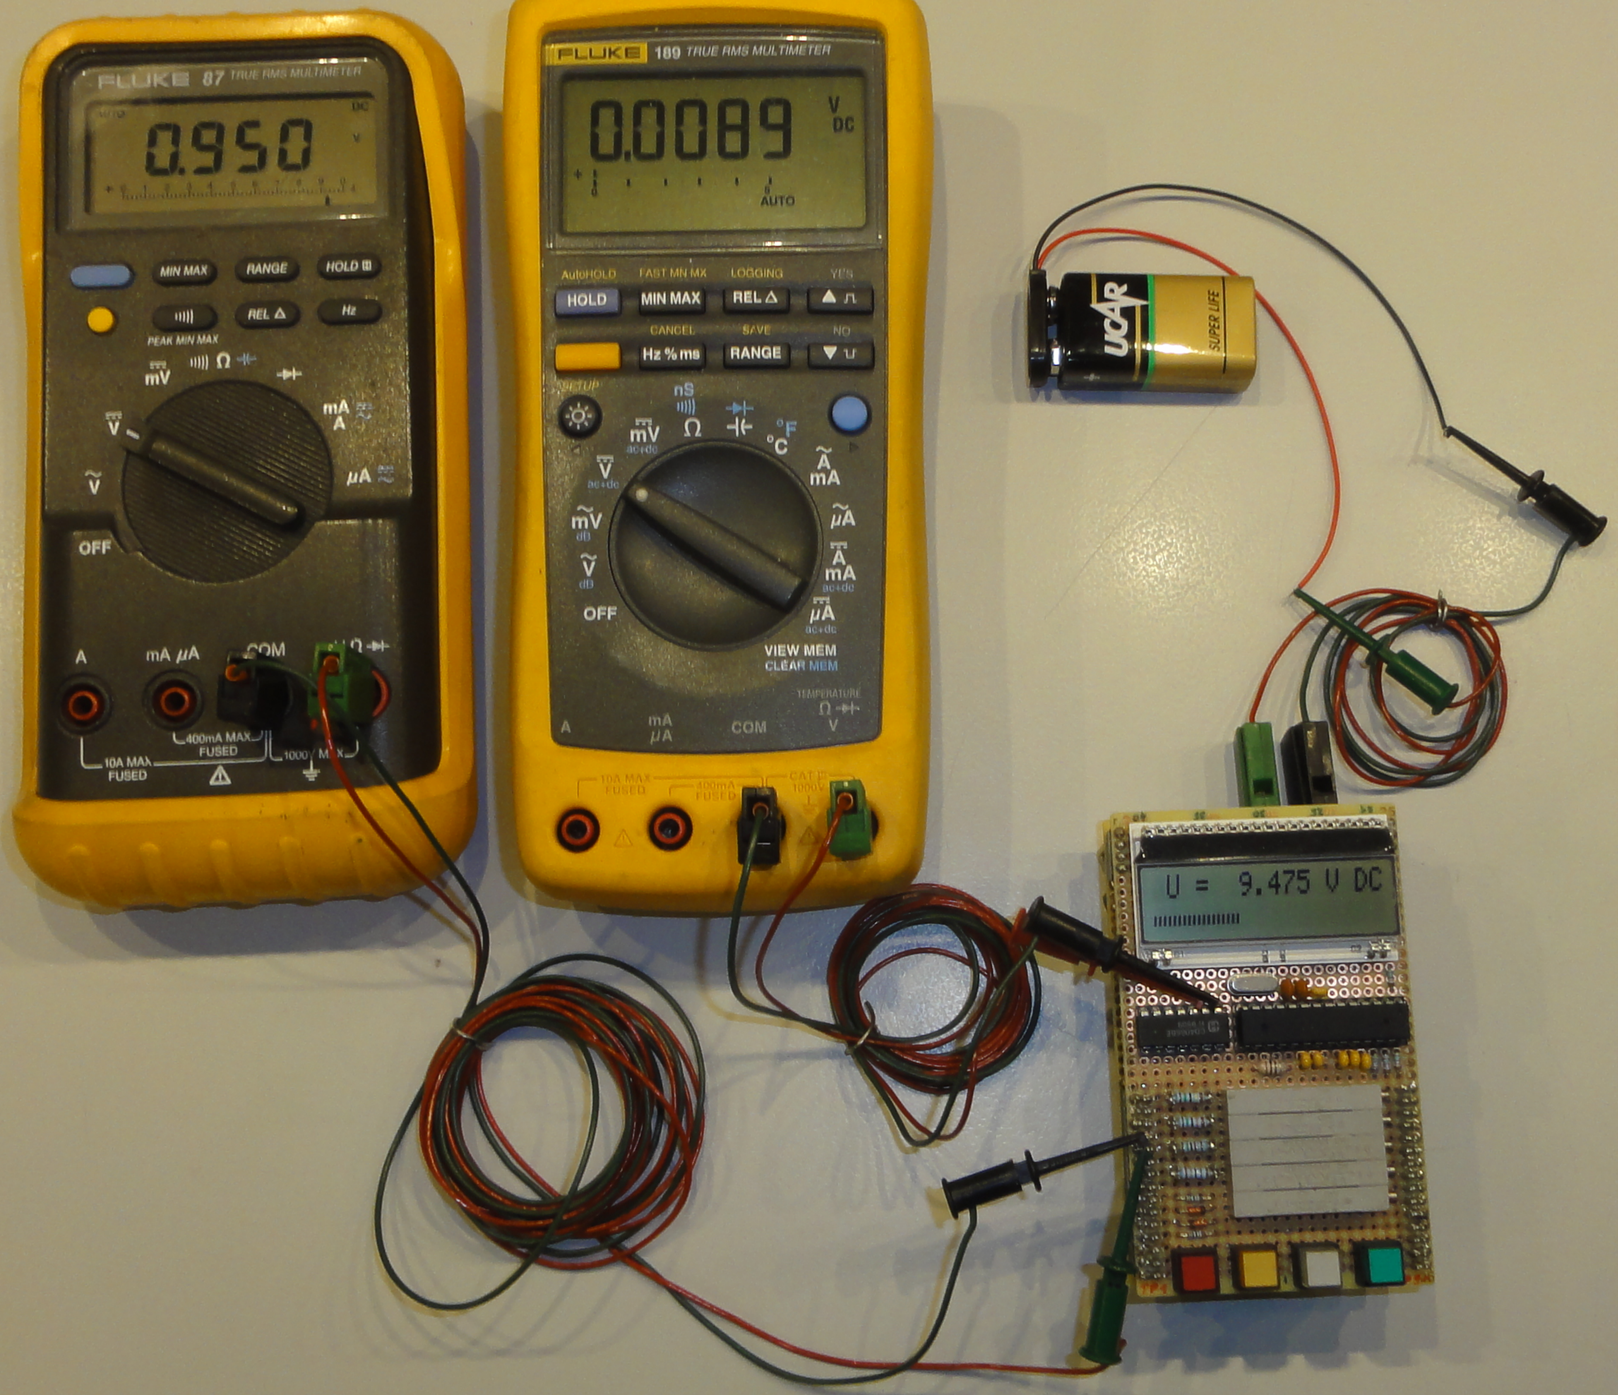
FLUKE 87 TRUE RMS MULTIMETER
0.950
MIN MAX
RANGE
HOLD
REL Δ
Hz
PEAK MIN MAX
OFF
A
mA µA
COM
10A MAX FUSED
400mA MAX FUSED
FLUKE 189 TRUE RMS MULTIMETER
0.0089
V DC
AUTO
AutoHOLD
FAST MN MX
LOGGING
HOLD
MIN MAX
REL Δ
CANCEL
SAVE
Hz % ms
RANGE
SETUP
OFF
VIEW MEM
CLEAR MEM
TEMPERATURE
A
mA µA
COM
U = 9.475 V DC